

SimClever

Medikal Simülasyonun Akıllı Hali



Sağlık Eğitim Simülatörleri

Ürün Kataloğu

İçindekiler

	Kod	Sayfa
 C-panel (Kontrol Modülü)	CM-01	1-2
 C-mon (Hibrit Hasta Monitörü)	BM-01	3-5
 C-aus (Oskültasyon Paketi)		
C-ound (Hibrit Dijital Stetoskop)	ST-01	6
C-pool (Akciğer, Kalp, GIS Oskültasyon Ses Kütüphanesi)	ST-02	7
C-tag (Konum Etiketi)	LM-01	7
 C-lab (Laboratuvar Modülü)	BM-02	8
 C-im (Tanısal Görüntüleme Modülü)	BM-02	9
 C-vent (Mekanik Ventilator Simulatörü)	MV-01	10-11
 C-lary (Hibrit Dijital Laringoskop / Hibrit Laringoskop)	LS-01	12-13
 C-defib (Hibrit Defibrilatör/Kardiyoverter/Pace/AED Simulatörü)	DF-01	14-16
 C-nario (Senaryo Oluşturma Modülü)	BM-03	17-18

Kolay Hızlı ve Mobil

Devrim niteliğindeki mobil simülasyon tabanlı eğitim çözümü, bir simülasyon merkezini sırt çantanızda taşıyabilir gibi her zaman ve her yerde kullanabilmenizi sağlar! Kırılma riski olmadan sorunsuz bir eğitim deneyimi sunar. Yenilikçi platformumuz, simülasyon tabanlı eğitimi nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenme süresini azaltır!




C-panel tüm SimClever modüllerini tek bir yerden bütünleşik olarak yönetmek için bir merkez gibi işlev görmektedir.

C-panel senaryoları sahne sahne oynatmanıza veya anlık değişiklikler yapmanıza olanak tanır; kontrol her zaman sizdedir.

Eğitim sırasında daha önce oluşturduğunuz sahneler arasında tek bir tıklamayla geçiş yapabilirsiniz ve **C-panel**, tüm modülleri (**C-mon**, **C-sound**, **C-lab**, **C-im**, **C-vent** vb.) tek bir yerden kontrol etmenizi sağlar. Bu özellik, her donanım için ayrı bilgisayar/cihaz ihtiyacını ortadan kaldırarak eğitiminizi daha verimli hale getirir ve senaryonun tek bir yerde depolanmasına izin verir.

Senaryo oynanırken eğiticinin ve eğitime katılanların yaptıkları anlık olarak **C-panel** 'e kaydedilir ve eğitimden sonra değerlendirmesi için eğitime bir rapor olarak sunulur. Ayrıca eğitmen eğitim sırasında kişisel notlar alabilir ve bunları belgeye kaydedebilir. Geribildirim (debriefing) oturumu böylece daha kolay ve verimli bir hale gelir.

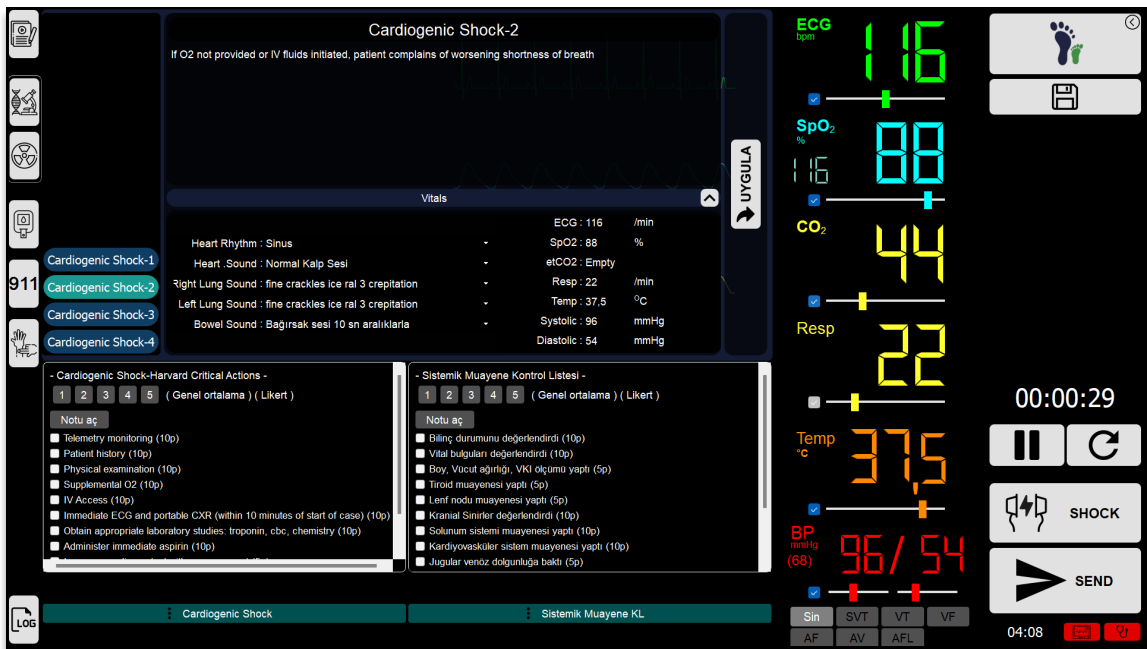

C-nario ve **C-panel** modülleri aracılığıyla, senaryo sırasında veya sonrasında, kontrol listelerini ve Likert ölçeklerini kullanarak eğitime katılanları değerlendirebilirsiniz. Eğitim bittiğinde ise değerlendirme puanları size otomatik sunulmaktadır. Bu notları bir rapor olarak alabilir veya arşivinizde saklayabilirsiniz.

Senaryo sırasında debriefing ekranında kullanılmak üzere notlar alabilirsiniz. Eğitim sırasında meydana gelen tüm vital bulgular, kontrol listeleri, dijital laringoskop ve mekanik ventilatörlerden gelen veriler, debriefing ekranında kullanılmak üzere otomatik olarak eğitim arşivine kaydedilir.

C-panel ile anlık olarak aşağıdaki kısımları kontrol edebilirsiniz.

- **C-mon** 'daki vitaller
 - **C-ound** 'daki Akciğer ve Kalp oksültasyon sesleri
 - **C-lab** 'daki sonuçlar
 - **C-im** 'deki görüntüler
 - **C-vent** 'deki akciğer dinamikleri
 - **C-lary** 'deki anlık görüntüler
 - **C-defib** 'deki durumlar
 - **C-nario** 'daki sahneler
- ve çok daha fazlası.....

Tek bir kontrol modülü (**C-panel**) ile hasta monitörü, laboratuvar, görüntüleme, ses, hibrit dijital stetoskop, mekanik ventilatör, dijital eğitim laringoskop modüllerini kontrol edebilir, senaryoları oynatabilir, senaryo sırasında ölçüm değerlendirmesi yapabilir ve debriefing modülüne gönderilmek üzere notlar alabilirsiniz.

C-mon sağlık profesyonellerine gelecekte karşılaşacakları durumları gösteren gerçekçi bir deneyim sunar. Öğrenciler, çeşitli hastalıklarda karşılaşılabilecekleri temel parametreleri (örneğin EKG, SPO₂, Solunum Sonu etCO₂, Solunum Hızı, Vücut Sıcaklığı ve Kan Basıncı) **C-mon** ile deneyimleyebilirler.


C-mon'un arayüzü hastanelerde kullanılan yatak başı monitörlere benzerdir ve sağlık çalışanlarının ve daylarının hasta izleme becerilerini geliştirir.


Mevcut Vital Belirtiler

- EKG
- SpO₂ ve grafikler
- etCO₂ ve grafikler
- Solunum hızı ve grafikler
- Vücut sıcaklığı
- Kan basıncı

Mevcut Kardiyak Ritimler

- Sinüs Ritmi
- Ventriküler taşikardi
- Supraventriküler taşikardi
- Ventriküler fibrilasyon
- Atriyal fibrilasyon
- Atriyoventriküler Blok (2:1)
- Atriyal Flutter

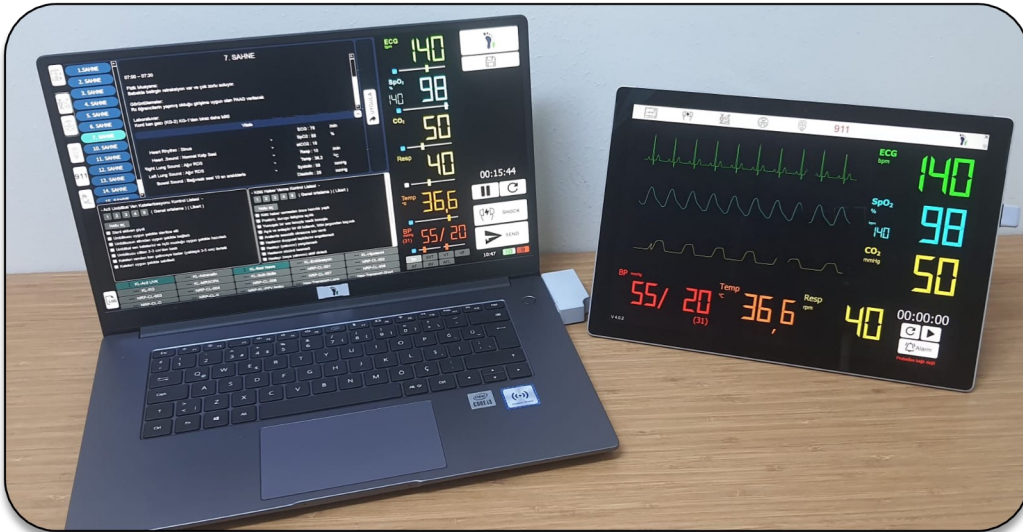

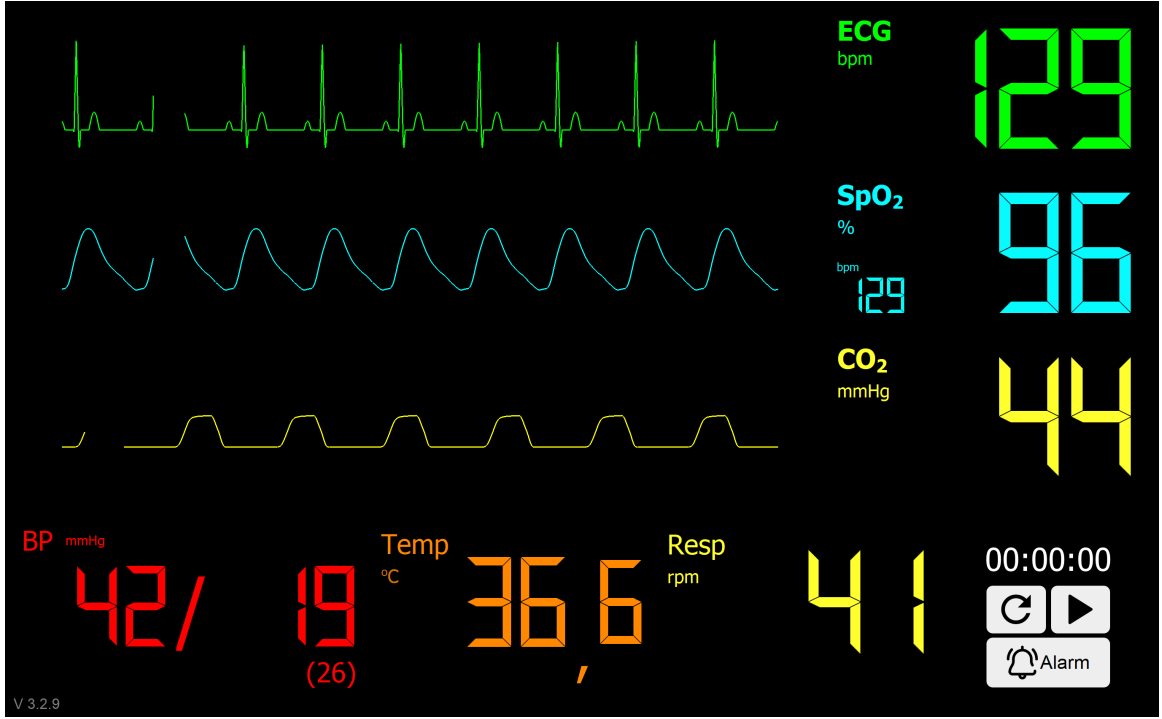

Tüm SimClever ürünleri gibi, **C-mon** da diğer SimClever ürünleri ile uyumludur. **C-ound** (Hibrit Dijital Stetoskop) ile birlikte kullanıldığında, öğrencilere **C-mon** 'da gösterilen temel parametrelerle uyumlu akciğer, kalp ve bağırsak seslerini deneyimleme imkanı sağlar.

Senaryo modülü (**C-nario**) ile kullanarak kendi senaryolarınızı oluşturabilirsiniz.



C-mon, bir tablet bilgisayar ile birlikte gelir ve farklı bir çözüme ihtiyaç duymadan yazılım aracılığıyla laboratuvar sonuçlarına, tanısal görüntüleme (örneğin göğüs röntgeni), fiziksel muayene ve klinik bilgilere erişmek için bir ekran olarak kullanılabilir.

C-panel (Simülasyon Tabanlı Tıp Eğitimi İçin Kontrol Modülü), **C-mon**'da farklı senaryoları yazmak ve yürütmek için gereklidir. Bu aynı yazılım, **C-mon**, **C-ound** ve **C-lary** gibi tüm SimClever ürünlerinizi tek bir yerden kontrol etmenizi sağlar. **C-mon**'u ayrı olarak satın alabilir veya aşağıda listelenen paketlerle birlikte satın alabilirsiniz.

Sanal Hastane Paketi (BM-01, BM-02, BM-03, ST-01, ST-02, LM-01, PC-01, TP-01, MV-01, LS-01, DF-01 + CM-01)

Sanal Klinik Paketi (BM-01, BM-02, BM-03, ST-01, ST-02, LM-01, PC-01, TP-01, DF-01 + CM-01)

Oskültasyon Paketi (C-aus) (ST-01, ST-02, LM-01, PC-01, CM-01)

Entübasyon Paketi (CM-01, 3 farklı boy LS-01)

Solunum Paketi (BM-01, BM-02, MV-01 + Oskültasyon + Entübasyon Paketi)

PC-01: Windows dizüstü bilgisayar TP-01: Windows tablet bilgisayar

Donanım ve Yazılımların birlikte çalışacağı bilgisayarlar SimCleverdan toplu olarak alınabilir veya kişisel bilgisayarınıza yazılımlar yüklenebilir. Yazılımın yükleneceği bilgisayarın minimum gereksinimleri karşılaması gerekmektedir.

C-aus (Oskültasyon Paketi), üç modülden oluşur: **C-ound** (Hibrit Dijital Stetoskop), **C-pool** (Akciğer, Kalp, GIS Oskültasyon Ses Kütüphanesi) ve **C-tag** (Konum İşareti). **C-aus**'u standart (simüle) hastalar, mankenler veya sadece yazılım aracılığıyla kullanabilirsiniz. Sınıf ve klinik ortamlar, **in-situ simülasyon** olarak adlandırılan simüle eğitim ortamlarına dönüşebilir.

C-ound Hibrit Dijital Stetoskop



Stetoskop, **C-tag** (konum işaretçileri) ile birlikte çalışır; standart hastalarda veya mankenlerde kullanılabilir. Sesler, **C-panel** ve **C-nario** modülleri tarafından anlık olarak veya senaryoya göre kontrol edilebilir.

C-ound'u kullanarak birçok genel ve özel tıbbi durumla ilgili olan kalp, akciğer ve bağırsak seslerini dinleyebilirsiniz. **C-ound**'dan sesleri duyabilmek için **C-tag** ile temas etmesi gerekmektedir. Hem **C-ound**'un hem de **C-mon**'un ritmi birlikte senkronize olarak çalışmaktadır.

C-panel ile birlikte kullanmak, eğitiminizde gerçekçiliği artırır. Senaryoya göre veya anlık modda istediğiniz kalp ve akciğer seslerinin hızı anında değiştirilebilir.

Kontrol modülünde kalp atış hızını artırdığınızda, hem hasta monitörü hem de stetoskop sesleri, senaryodaki hıza göre gerçekçi bir şekilde değişir.



C-pool, **C-nario** ve **C-tag** ten oluşur.

C-pool Oskültasyon Ses Kütüphanesi

C-pool, gerçek bir tıbbi vakada duyulabilecek 50'den fazla kalp, akciğer ve bağırsak sesini içeren bir veritabanıdır. Eğitiminiz için uygun sesi C-panel üzerinden seçmeniz ve istediğiniz sıklığı ayarlamanız yeterlidir. Böylece çok gerçekçi bir deneyim yaşayabilirsiniz.




Dijital stetoskoplar kullanılarak gerçek hastalardan alınan ses kayıtları size en gerçekçi deneyimi sağlamak için düzenlendi. Ritmi değiştirmek isterseniz kaliteden taviz vermeden en gerçekçi sese ulaşmanız çok kolay. Stetoskoptaki ses, herhangi bir kalite kaybı olmadan ritimle birlikte değişmektedir.

C-pool, **C-nario** yazılımını kullanarak senaryolarınıza sesleri eklemenize olanak tanır.

C-tag Konum Etiketi

C-tag'ler hem standart (simüle) hastalar hem de mankenlerde kullanılarak çeşitli akciğer, kalp ve bağırsak seslerini dinleyebilirsiniz. **C-ound** stetoskopunuzu **C-tag** etiketine dokundurun ve senaryonuza uygun sesi duyacaksınız bu kadar basit! **C-tag**'ler aynı zamanda mankenin içine de yerleştirilebilir ve ekipmanınıza zarar vermeyecek malzemeden yapılmıştır. **C-aus** paketi 30 adet yeniden kullanılabilir **C-tag** ile birlikte gelir ve daha fazla etikete ihtiyacınız olması durumunda sitemiz üzerinden sipariş verebilirsiniz

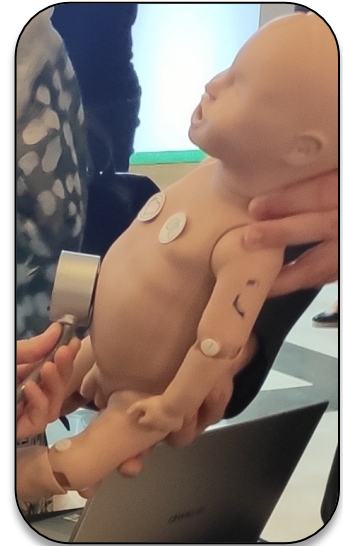

Klinik muhakeme için laboratuvar sonuçları son derece önemlidir. Öğrenciler, senaryo ile ilişkilendirilmiş herhangi bir laboratuvar sonucunu **C-lab** ekranlarında görebilirler.

Laboratuvar sonuçlarını göstermek için ikinci bir ekran veya kağıtlara ihtiyacınız yok! **C-lab**'a erişebilmek için **C-mon** yazılımının içindeki **C-lab** sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Yani **C-lab**'ı kullanmak için ikinci bir donanım (talbet/bilgisayar) satın almanıza gerek yok; sadece yazılımınızı yükseltmeniz yeterli olacaktır.



Kullanıma Hazır Laboratuvar Şablonları

- Hemogram
- Kan gazı analizi
- Biyokimyasal analiz
- Vitaminler
- Kardiyak panel
- Anemia paneli
- Beyin omurilik sıvısı analizi
- Pıhtılaşma paneli
- Lipid paneli
- Tiroid fonksiyon testleri

C-nario yazılımını kullanarak senaryolarınıza herhangi bir laboratuvar testini ekleyebilirsiniz; ya da yazılımınızdaki önceden yüklenmiş laboratuvar sonuçlarını ve senaryolarını kullanabilirsiniz.

Test Adı	Durum	Değer	Birim	Referans
WBC(White Blood Cells)	▼	18.58	/mm3	4500 - 10000
LY#(Lenfosit Count)	▼	3.93	/mm3	800 - 4000
Monosit Count	▼	1.43	/mm3	120 - 1200
Neutrophyl Count	▼	12.61	/mm3	2000 - 7000
Eosinophyl Count	▼	0.44	/mm3	20 - 500
Basophyl Count	-	0.17	/mm3	0 - 100
Lenfosit %	-	21.1	%	20 - 40
Monosit %	-	7.7	%	3 - 12
Neutrophyl %	-	67.9	%	50 - 70
Eosinophyl %	-	2.0	%	0.5 - 5
Basophyl %	-	0.9	%	0 - 1
RBC	-	5.46	%	3.5 - 5.5
Hgb (Hemoglobin)	▲	16.3	g/dL	11 - 16
Htc	-	50.2	%	37 - 54
MCV	-	91.9	fL	80 - 100
MCH	-	29.9	Pg	27 - 34

Hekimler için, hangi görüntüleme tekniklerinin ne zaman uygulanacağına karar vermek klinik muhakemenin önemli bir parçasıdır. Ayrıca, bu tekniklerin sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendirmeyi de içerir.

C-im'i kullanarak senaryolarınızı daha gerçekçi bir şekilde simüle edebilir ve öğrencilerinizin gerçek hastalara müdahale ediyormuş gibi gerçek yaşam durumlarını deneyimlemelerini sağlayabilirsiniz.




X-Ray, MR, USG gibi yazılımında içinde gelen hazır görüntüleri kullanabilir veya kendi görüntülerinizi **C-nario** yazılımını kullanarak senaryolarınıza yükleyebilirsiniz.

Görüntü sonuçlarını göstermek için ikinci bir ekrana veya kağıtlara ihtiyacınız yoktur. **C-im**'e erişebilmek için **C-mon** yazılımının içindeki **C-im** sekmesine tıklamanız yeterli olacaktır. Yani **C-im**'i kullanmak için ikinci bir donanım satın almanıza gerek yok; sadece yazılımınızı yükseltmeniz yeterli olacaktır.




C-vent, gelişmiş akciğer fizyolojisi ve mobilite sunan, son derece kullanıcı dostu bir mekanik ventilatör simulatörüdür. **C-vent** kullanarak mekanik ventilasyon becerilerinizi her zaman ve her yerde geliştirebilirsiniz. **C-nario** modülünü kullanarak kendi senaryolarınızı oluşturabilirsiniz.

Önceden tasarlanmış senaryolardan seçim yapabilir veya akciğer kompliansını, hava yolunun direncini, toplam akciğer kapasitesini ve spontan solunumu ayarlayarak kendi senaryolarınızı oluşturabilirsiniz.

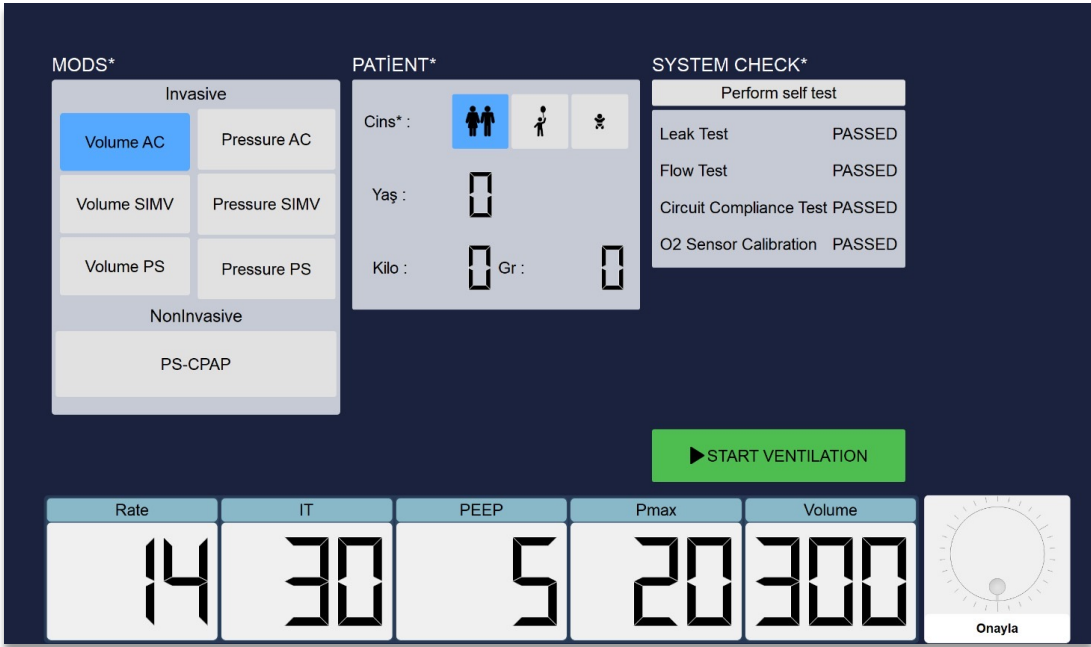

C-vent kullanarak mekanik ventilasyon yöntemlerinden non-invaziv nCPAP, nIMV ve invaziv AC (basınç veya hacim), SIMV (basınç veya hacim), Basınç Destek (basınç veya hacim) ve IMV gibi çeşitli modlar arasından seçim yapabilirsiniz. **C-vent** ekranında PIP, PEEP, TV (VG modları için), IT (inspiryum zamanı) ve Rate (hız) gibi parametreleri ayarlayabilir ve hastadan gelen eTV (expiryumdaki tidal volüm), MV (minute ventilation), spontan solunum hızı, kaçak gibi parametreleri senaryodaki akciğer dinamiklerine göre yine **C-vent** ekranından takip edebilirsiniz.

Ekibinizin solunum yetmezliği olan bir hasaya tanı koyma ve bu hastayı yönetimini **C-vent** kullanarak istediğiniz sıklıkta ve hastaya zarar verme ihtimali olmadan arttırabilirsiniz. **C-vent** ekibinizin bilgi/tecrübesini geliştirmek için çeşitli zorlukta vakalar sunar.

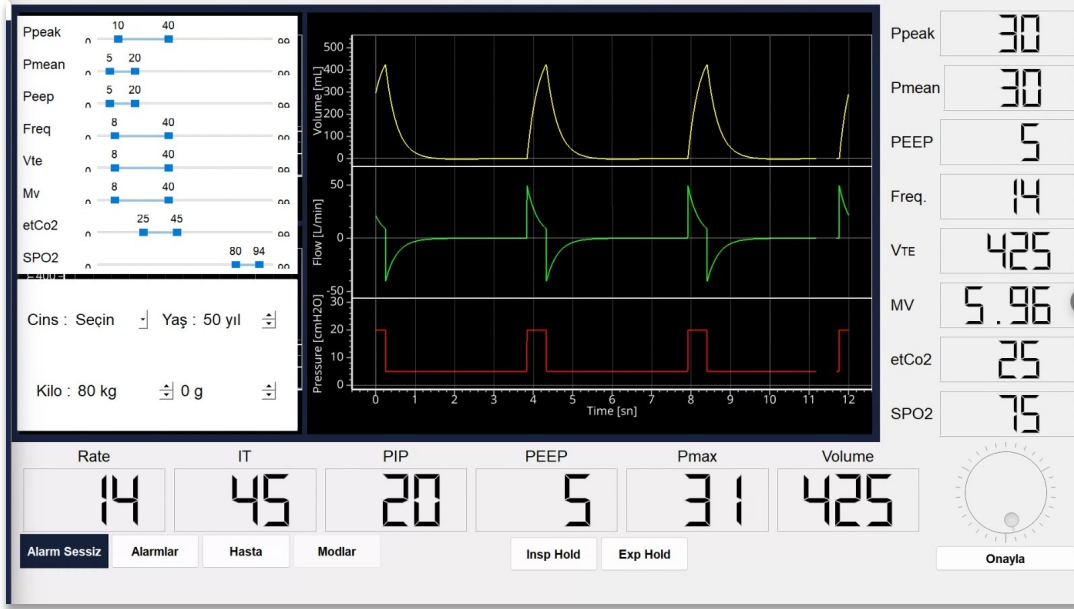

C-lary'yi kullanarak mankeninizde entübasyon işlemini tüm ekip görecektir şekilde gerçekleştirebilir, entübasyon eğitimi çok daha etkili verebilir ve senaryolar sırasında entübasyon doğrulunu kontrol edebilirsiniz.

Mevcut invaziv MV Modları

- Basınç AC
- Hacim AC
- Basınç SIMV
- Hacim SIMV
- Basınç PS
- Hacim PS

Mevcut Non-invaziv MV Modları

- nCPAP
- nIMV

C-lary Hibrit Dijital Laringoskop

C-lary eğitim amaçlı tasarlanmış yenilikçi bir dijital laringoskopdur. Üzerine bir kamera ve ışık takılmış olan bir laringoskop olarak işlev görür, öğrenciler için gerçekçi ve pratik bir deneyim sağlarken, senaryo sırasında gerçek hayatta olduğu gibi tüm ekibin entübasyonu takip etmesini sağlar.




C-lary'yi kullanarak öğrenciler, gerçek dijital laringoskoplarda olduğu gibi ekrandan anlık görüntüler alırken mankeni entübe edebilirler. Simülasyonu denetleyen eğitmen ayrıca entübasyon sürecini gerçek zamanlı olarak **C-panel** üzerinden izleyebilir ve değerlendirme (debriefing) oturumlarında kullanmak üzere saklayabilir.

Bu, eğitmenlere entübasyon sürecindeki performanslarına dayalı olarak öğrencilere kaliteli bir geri bildirim sağlama imkanı tanır. Ek olarak, istenirse, entübasyon sürecinin videosu tüm öğrencilerin izleyebilmesi ve öğrenmesi için sınıf ekranına yansıtılabilir.




C-lary yenidoğan, pediatrik ve yetişkin hastalar için çeşitli boyutlarda gelmektedir ve bu da tüm seviyelerdeki öğrenciler için kapsamlı bir öğrenme deneyimi sağlar.

Görüntülerin kablosuz olarak aktarılması, kablo kalabalığını ortadan kaldırarak öğrenme ortamını daha verimli ve düzenli hale getirir.

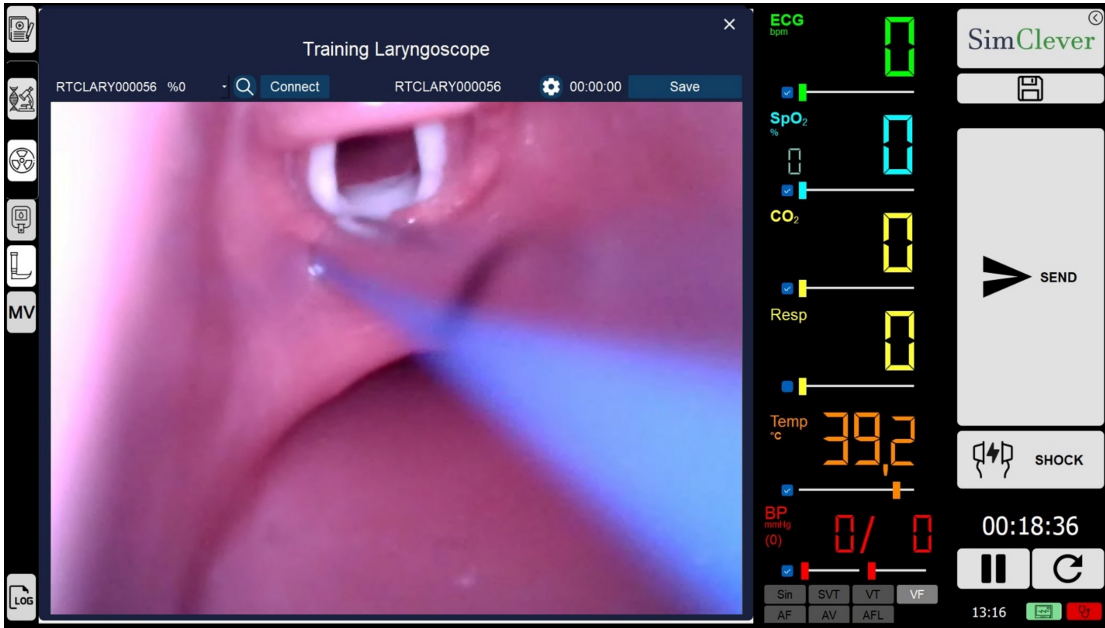

Yani, C-lary sağlık çalışanlarının ve adaylarının gerçek hastalara müdahale etmeden önce entübasyon becerilerini mükemmelleştirmelerine imkan tanır.

C-defib elektrik çarpma riski olmadan gerçekçi bir defibrilasyon/kardiyoversiyon deneyimlemek ve eğitim sağlamak üzere geliştirilmiştir. Yazılım ve senaryo ile uyum içinde çalışan defibrilatör kaşıklarını gerçekçi bir deneyim yaşamak için kullanabilirsiniz veya sadece yazılımdaki düğmeleri kullanarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yazılımla entegre çalışan defibrilatör kaşıkları, gerçek defibrilatör kaşıklarının hassasiyetine sahiptir ve yeterince sıkı bastırılmazsa veya üzerlerindeki düğmelere basılmazsa deşarj olmazlar. Bu kaşıklarda elektrik yoktur ve defibrilasyon-kardiyoversiyon işlemleri, istediğiniz senaryoya göre yazılım yoluyla simüle edilir. Bu sayede eğitime katılanların kendilerine veya makete zarar verme ihtimali ortadan kalkar.

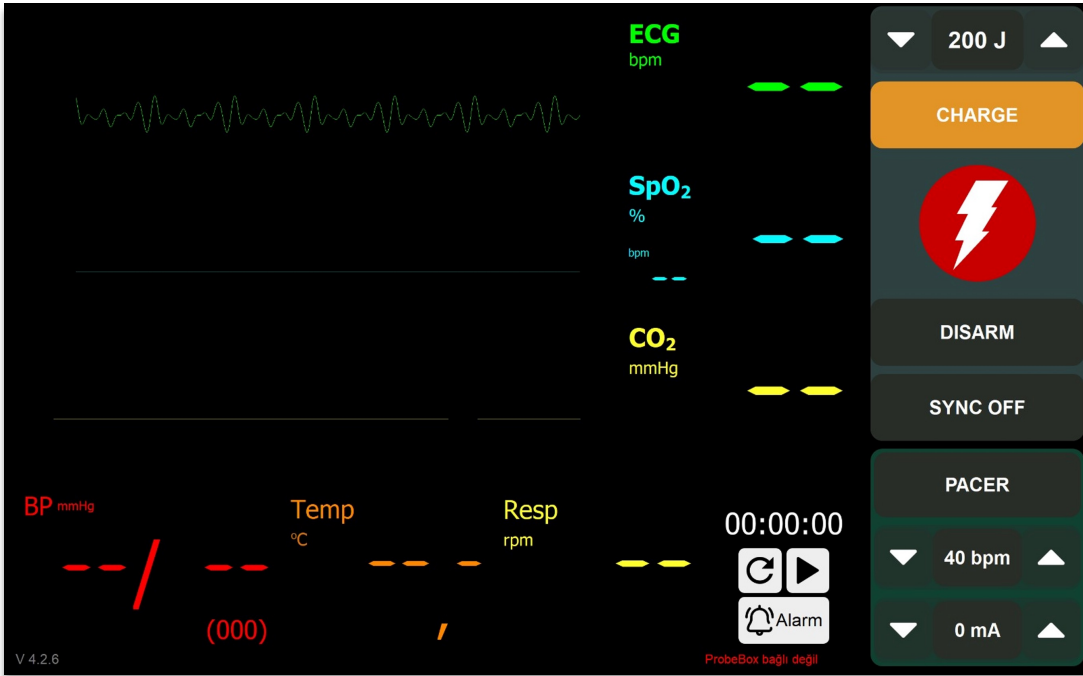

C-defib yazılımını ve kaşıklarını kullanarak herhangi bir beceri mankenine veya standart (simüle edilmiş) hastaya elektroşok uygulayabilir ve ritimlerini tablet ekranında (**C-mon**) gözlemleyebilirsiniz.



Farklı eğitim ortamlarına göre, **C-defib** kaşıkları olmadan sadece tabletteki buton kullanılıp elektroşok uygulayarak teorik eğitimi en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Bu yöntem, klasik ders sunumları sırasında eğitimi zenginleştirmek için de kullanılabilir.



C-defib modülünde, senkronize kardiyoversiyon, defibrilasyon veya pacemaker olarak kullanmak üzere gerçek bir defibrilatör cihazında olduğu gibi enerji ayarlamaları yapabilirsiniz.

Eğitmen hangi uygulamanın hastada hangi sonuçlar vereceğini **C-nario** ile sahneler halinde yazarak eğitim sırasında bu sahneleri kullanarak ayarlayabilir veya anlık olarak (on the fly) **C-panel** aracılığıyla katılımcıların performansına göre senaryo sırasında karar verebilir.


Defibrilatörlerde kullanılan deşarj ve senkronize etme gibi düğmeler, **C-defib** ekranında gerçek defibrilatör cihazlarındaki yerlere benzer yerlere yerleştirilmiştir; bu sayede öğrencileriniz kendilerine, etraflarındakilere veya mankene zarar vermeden ileri düzey defibrilasyon deneyimi yaşayabilirler.

C-defib kaşıkları temas olmadan çalışmayacak şekilde dizayn edilmiştir. Manken veya simüle hastaya şok uygulamak için her iki kaşığın tamamen yerleştirilmesi ve üzerlerindeki düğmelere basılması gerekir.




C-defib kaşıklarını simüle/standart hastalar üzerinde de onlara zarar verme ihtimali olmadan kullanabilirsiniz, bu eğitimlerde gerçekçiliği en üst düzeye taşıyacaktır.

C-defib kullanmak için ikinci bir donanım ekranı satın almanıza gerek yoktur. Ürünü yazılımsal olarak yükselttikten sonra **C-mon** ekranındaki sekmelerden ilgili olanı kullanarak **C-defib** ekranına geçebilirsiniz. **C-mon** ve **C-defib** arasında tek bir tıklamayla geçiş yapabilirsiniz, tıpkı **C-vent** ve **C-lary** ekranları arasında olduğu gibi.

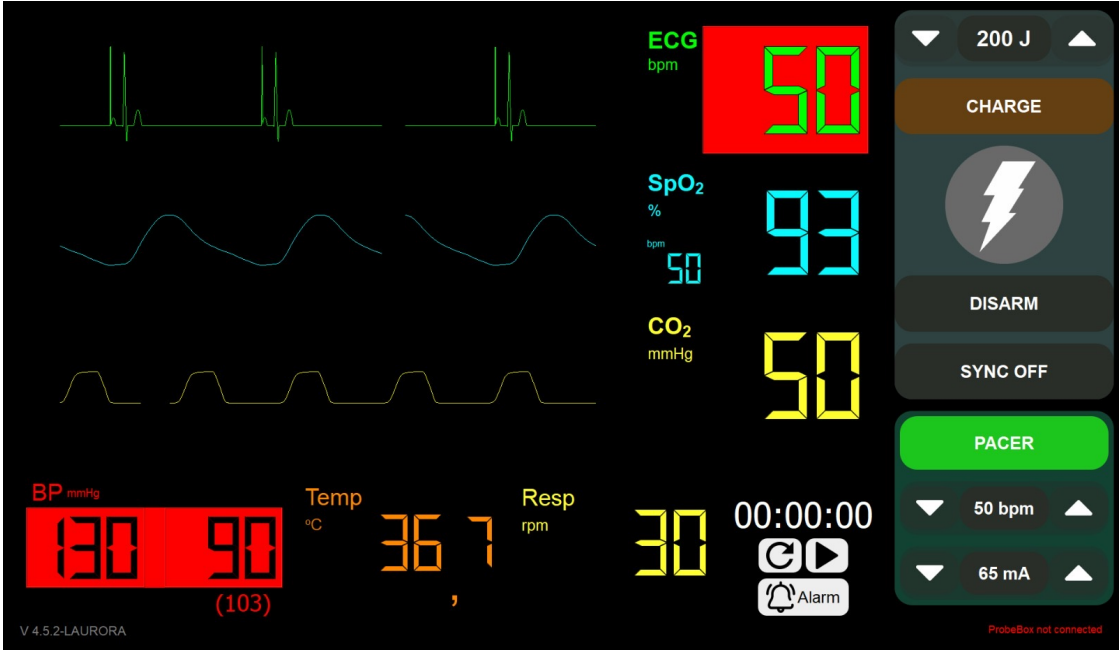

C-nario modülü ile senaryonuzda birden fazla sahne oluşturma ve her sahne için akciğer dinamikleri, laboratuvar sonuçları ve görüntüleme gibi temel bulguları otomatikleştirme özgürlüğüne sahipsiniz.

Tek bir yerden senaryonuzu kolayca kontrol edebilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Eğitim sırasında, dallanma özelliği sayesinde farklı sahneler arasında sadece bir düğme ile geçiş yapabilirsiniz.

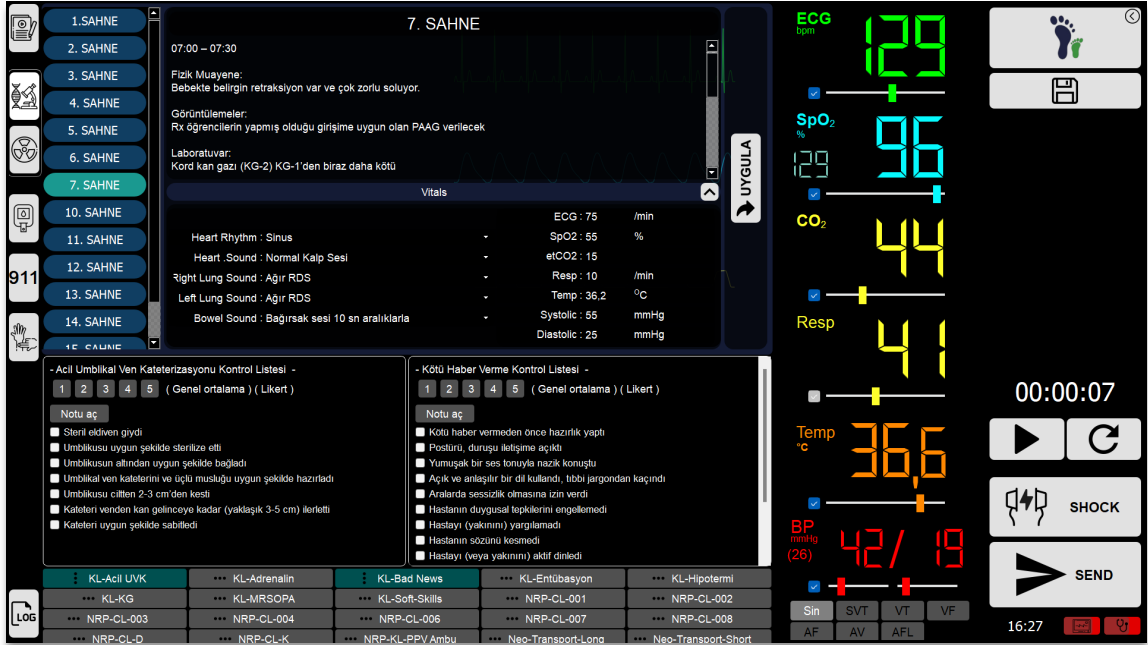

7. SAHNE
07:00 – 07:30
Fizik Muayene: Bebekte belirgin retraksiyon var ve çok zorlu soluyor.
Görüntülemeler: Rx öğrencilerin yapmış olduğu girişime uygun olan PAAG verilecek
Laboratuvar: Kord kan gazı (KG-2) KG-1'den biraz daha kötü


Vitals

Heart Rhythm : Sinus	ECG : 75 /min
Heart Sound : Normal Kalp Sesi	SpO2 : 55 %
Right Lung Sound : Ağır RDS	etCO2 : 15
Left Lung Sound : Ağır RDS	Resp : 10 /min
Bowel Sound : Bağırsak sesi 10 sn aralıklarla	Temp : 36.2 °C
	Systolic : 55 mmHg
	Diastolic : 25 mmHg

- Acil Umbilikal Ven Kateterizasyonu Kontrol Listesi -
1 2 3 4 5 (Genel ortalama) (Likert)
Notu aç
☐ Steril eldiven giydi
☐ Umblikusun uygun şekilde sterilize etti
☐ Umblikusun altından uygun şekilde bağladı
☐ Umbilikal ven kateterini ve tüpü musluğu uygun şekilde hazırladı
☐ Umblikusu ciltten 2-3 cm'den kesti
☐ Kateteri venden kan gelinceye kadar (yaklaşık 3-5 cm) ilerletti
☐ Kateteri uygun şekilde sabitledi

- Kötü Haber Verme Kontrol Listesi -
1 2 3 4 5 (Genel ortalama) (Likert)
Notu aç
☐ Kötü haber vermeden önce hazırlık yaptı
☐ Postürü, duruşu iletişime açıldı
☐ Yumuşak bir ses tonuyla nazik konuştu
☐ Açık ve anlaşılır bir dil kullandı, tıbbi jargondan kaçındı
☐ Aralarda sessizlik olmasına izin verdi
☐ Hastanın duygusal tepkilerini engellemeyi
☐ Hastayı (yakınına) yargılamadı
☐ Hastanın sözünü kesmedi
☐ Hastayı (veya yakınına) aktif dinledi

KL-Bad News
KL-Adrenalin
KL-MRSOPA
KL-Soft-Skills
KL-CL-001
KL-CL-002
KL-CL-003
KL-CL-004
KL-CL-005
KL-CL-006
KL-CL-007
KL-CL-008
KL-CL-009
KL-CL-010
KL-CL-011
KL-CL-012
KL-CL-013
KL-CL-014
KL-CL-015
KL-CL-016
KL-CL-017
KL-CL-018
KL-CL-019
KL-CL-020
KL-CL-021
KL-CL-022
KL-CL-023
KL-CL-024
KL-CL-025
KL-CL-026
KL-CL-027
KL-CL-028
KL-CL-029
KL-CL-030
KL-CL-031
KL-CL-032
KL-CL-033
KL-CL-034
KL-CL-035
KL-CL-036
KL-CL-037
KL-CL-038
KL-CL-039
KL-CL-040
KL-CL-041
KL-CL-042
KL-CL-043
KL-CL-044
KL-CL-045
KL-CL-046
KL-CL-047
KL-CL-048
KL-CL-049
KL-CL-050
KL-CL-051
KL-CL-052
KL-CL-053
KL-CL-054
KL-CL-055
KL-CL-056
KL-CL-057
KL-CL-058
KL-CL-059
KL-CL-060
KL-CL-061
KL-CL-062
KL-CL-063
KL-CL-064
KL-CL-065
KL-CL-066
KL-CL-067
KL-CL-068
KL-CL-069
KL-CL-070
KL-CL-071
KL-CL-072
KL-CL-073
KL-CL-074
KL-CL-075
KL-CL-076
KL-CL-077
KL-CL-078
KL-CL-079
KL-CL-080
KL-CL-081
KL-CL-082
KL-CL-083
KL-CL-084
KL-CL-085
KL-CL-086
KL-CL-087
KL-CL-088
KL-CL-089
KL-CL-090
KL-CL-091
KL-CL-092
KL-CL-093
KL-CL-094
KL-CL-095
KL-CL-096
KL-CL-097
KL-CL-098
KL-CL-099
KL-CL-100
KL-CL-101
KL-CL-102
KL-CL-103
KL-CL-104
KL-CL-105
KL-CL-106
KL-CL-107
KL-CL-108
KL-CL-109
KL-CL-110
KL-CL-111
KL-CL-112
KL-CL-113
KL-CL-114
KL-CL-115
KL-CL-116
KL-CL-117
KL-CL-118
KL-CL-119
KL-CL-120
KL-CL-121
KL-CL-122
KL-CL-123
KL-CL-124
KL-CL-125
KL-CL-126
KL-CL-127
KL-CL-128
KL-CL-129
KL-CL-130
KL-CL-131
KL-CL-132
KL-CL-133
KL-CL-134
KL-CL-135
KL-CL-136
KL-CL-137
KL-CL-138
KL-CL-139
KL-CL-140
KL-CL-141
KL-CL-142
KL-CL-143
KL-CL-144
KL-CL-145
KL-CL-146
KL-CL-147
KL-CL-148
KL-CL-149
KL-CL-150
KL-CL-151
KL-CL-152
KL-CL-153
KL-CL-154
KL-CL-155
KL-CL-156
KL-CL-157
KL-CL-158
KL-CL-159
KL-CL-160
KL-CL-161
KL-CL-162
KL-CL-163
KL-CL-164
KL-CL-165
KL-CL-166
KL-CL-167
KL-CL-168
KL-CL-169
KL-CL-170
KL-CL-171
KL-CL-172
KL-CL-173
KL-CL-174
KL-CL-175
KL-CL-176
KL-CL-177
KL-CL-178
KL-CL-179
KL-CL-180
KL-CL-181
KL-CL-182
KL-CL-183
KL-CL-184
KL-CL-185
KL-CL-186
KL-CL-187
KL-CL-188
KL-CL-189
KL-CL-190
KL-CL-191
KL-CL-192
KL-CL-193
KL-CL-194
KL-CL-195
KL-CL-196
KL-CL-197
KL-CL-198
KL-CL-199
KL-CL-200
KL-CL-201
KL-CL-202
KL-CL-203
KL-CL-204
KL-CL-205
KL-CL-206
KL-CL-207
KL-CL-208
KL-CL-209
KL-CL-210
KL-CL-211
KL-CL-212
KL-CL-213
KL-CL-214
KL-CL-215
KL-CL-216
KL-CL-217
KL-CL-218
KL-CL-219
KL-CL-220
KL-CL-221
KL-CL-222
KL-CL-223
KL-CL-224
KL-CL-225
KL-CL-226
KL-CL-227
KL-CL-228
KL-CL-229
KL-CL-230
KL-CL-231
KL-CL-232
KL-CL-233
KL-CL-234
KL-CL-235
KL-CL-236
KL-CL-237
KL-CL-238
KL-CL-239
KL-CL-240
KL-CL-241
KL-CL-242
KL-CL-243
KL-CL-244
KL-CL-245
KL-CL-246
KL-CL-247
KL-CL-248
KL-CL-249
KL-CL-250
KL-CL-251
KL-CL-252
KL-CL-253
KL-CL-254
KL-CL-255
KL-CL-256
KL-CL-257
KL-CL-258
KL-CL-259
KL-CL-260
KL-CL-261
KL-CL-262
KL-CL-263
KL-CL-264
KL-CL-265
KL-CL-266
KL-CL-267
KL-CL-268
KL-CL-269
KL-CL-270
KL-CL-271
KL-CL-272
KL-CL-273
KL-CL-274
KL-CL-275
KL-CL-276
KL-CL-277
KL-CL-278
KL-CL-279
KL-CL-280
KL-CL-281
KL-CL-282
KL-CL-283
KL-CL-284
KL-CL-285
KL-CL-286
KL-CL-287
KL-CL-288
KL-CL-289
KL-CL-290
KL-CL-291
KL-CL-292
KL-CL-293
KL-CL-294
KL-CL-295
KL-CL-296
KL-CL-297
KL-CL-298
KL-CL-299
KL-CL-300
KL-CL-301
KL-CL-302
KL-CL-303
KL-CL-304
KL-CL-305
KL-CL-306
KL-CL-307
KL-CL-308
KL-CL-309
KL-CL-310
KL-CL-311
KL-CL-312
KL-CL-313
KL-CL-314
KL-CL-315
KL-CL-316
KL-CL-317
KL-CL-318
KL-CL-319
KL-CL-320
KL-CL-321
KL-CL-322
KL-CL-323
KL-CL-324
KL-CL-325
KL-CL-326
KL-CL-327
KL-CL-328
KL-CL-329
KL-CL-330
KL-CL-331
KL-CL-332
KL-CL-333
KL-CL-334
KL-CL-335
KL-CL-336
KL-CL-337
KL-CL-338
KL-CL-339
KL-CL-340
KL-CL-341
KL-CL-342
KL-CL-343
KL-CL-344
KL-CL-345
KL-CL-346
KL-CL-347
KL-CL-348
KL-CL-349
KL-CL-350
KL-CL-351
KL-CL-352
KL-CL-353
KL-CL-354
KL-CL-355
KL-CL-356
KL-CL-357
KL-CL-358
KL-CL-359
KL-CL-360
KL-CL-361
KL-CL-362
KL-CL-363
KL-CL-364
KL-CL-365
KL-CL-366
KL-CL-367
KL-CL-368
KL-CL-369
KL-CL-370
KL-CL-371
KL-CL-372
KL-CL-373
KL-CL-374
KL-CL-375
KL-CL-376
KL-CL-377
KL-CL-378
KL-CL-379
KL-CL-380
KL-CL-381
KL-CL-382
KL-CL-383
KL-CL-384
KL-CL-385
KL-CL-386
KL-CL-387
KL-CL-388
KL-CL-389
KL-CL-390
KL-CL-391
KL-CL-392
KL-CL-393
KL-CL-394
KL-CL-395
KL-CL-396
KL-CL-397
KL-CL-398
KL-CL-399
KL-CL-400
KL-CL-401
KL-CL-402
KL-CL-403
KL-CL-404
KL-CL-405
KL-CL-406
KL-CL-407
KL-CL-408
KL-CL-409
KL-CL-410
KL-CL-411
KL-CL-412
KL-CL-413
KL-CL-414
KL-CL-415
KL-CL-416
KL-CL-417
KL-CL-418
KL-CL-419
KL-CL-420
KL-CL-421
KL-CL-422
KL-CL-423
KL-CL-424
KL-CL-425
KL-CL-426
KL-CL-427
KL-CL-428
KL-CL-429
KL-CL-430
KL-CL-431
KL-CL-432
KL-CL-433
KL-CL-434
KL-CL-435
KL-CL-436
KL-CL-437
KL-CL-438
KL-CL-439
KL-CL-440
KL-CL-441
KL-CL-442
KL-CL-443
KL-CL-444
KL-CL-445
KL-CL-446
KL-CL-447
KL-CL-448
KL-CL-449
KL-CL-450
KL-CL-451
KL-CL-452
KL-CL-453
KL-CL-454
KL-CL-455
KL-CL-456
KL-CL-457
KL-CL-458
KL-CL-459
KL-CL-460
KL-CL-461
KL-CL-462
KL-CL-463
KL-CL-464
KL-CL-465
KL-CL-466
KL-CL-467
KL-CL-468
KL-CL-469
KL-CL-470
KL-CL-471
KL-CL-472
KL-CL-473
KL-CL-474
KL-CL-475
KL-CL-476
KL-CL-477
KL-CL-478
KL-CL-479
KL-CL-480
KL-CL-481
KL-CL-482
KL-CL-483
KL-CL-484
KL-CL-485
KL-CL-486
KL-CL-487
KL-CL-488
KL-CL-489
KL-CL-490
KL-CL-491
KL-CL-492
KL-CL-493
KL-CL-494
KL-CL-495
KL-CL-496
KL-CL-497
KL-CL-498
KL-CL-499
KL-CL-500
KL-CL-501
KL-CL-502
KL-CL-503
KL-CL-504
KL-CL-505
KL-CL-506
KL-CL-507
KL-CL-508
KL-CL-509
KL-CL-510
KL-CL-511
KL-CL-512
KL-CL-513
KL-CL-514
KL-CL-515
KL-CL-516
KL-CL-517
KL-CL-518
KL-CL-519
KL-CL-520
KL-CL-521
KL-CL-522
KL-CL-523
KL-CL-524
KL-CL-525
KL-CL-526
KL-CL-527
KL-CL-528
KL-CL-529
KL-CL-530
KL-CL-531
KL-CL-532
KL-CL-533
KL-CL-534
KL-CL-535
KL-CL-536
KL-CL-537
KL-CL-538
KL-CL-539
KL-CL-540
KL-CL-541
KL-CL-542
KL-CL-543
KL-CL-544
KL-CL-545
KL-CL-546
KL-CL-547
KL-CL-548
KL-CL-549
KL-CL-550
KL-CL-551
KL-CL-552
KL-CL-553
KL-CL-554
KL-CL-555
KL-CL-556
KL-CL-557
KL-CL-558
KL-CL-559
KL-CL-560
KL-CL-561
KL-CL-562
KL-CL-563
KL-CL-564
KL-CL-565
KL-CL-566
KL-CL-567
KL-CL-568
KL-CL-569
KL-CL-570
KL-CL-571
KL-CL-572
KL-CL-573
KL-CL-574
KL-CL-575
KL-CL-576
KL-CL-577
KL-CL-578
KL-CL-579
KL-CL-580
KL-CL-581
KL-CL-582
KL-CL-583
KL-CL-584
KL-CL-585
KL-CL-586
KL-CL-587
KL-CL-588
KL-CL-589
KL-CL-590
KL-CL-591
KL-CL-592
KL-CL-593
KL-CL-594
KL-CL-595
KL-CL-596
KL-CL-597
KL-CL-598
KL-CL-599
KL-CL-600
KL-CL-601
KL-CL-602
KL-CL-603
KL-CL-604
KL-CL-605
KL-CL-606
KL-CL-607
KL-CL-608
KL-CL-609
KL-CL-610
KL-CL-611
KL-CL-612
KL-CL-613
KL-CL-614
KL-CL-615
KL-CL-616
KL-CL-617
KL-CL-618
KL-CL-619
KL-CL-620
KL-CL-621
KL-CL-622
KL-CL-623
KL-CL-624
KL-CL-625
KL-CL-626
KL-CL-627
KL-CL-628
KL-CL-629
KL-CL-630
KL-CL-631
KL-CL-632
KL-CL-633
KL-CL-634
KL-CL-635
KL-CL-636
KL-CL-637
KL-CL-638
KL-CL-639
KL-CL-640
KL-CL-641
KL-CL-642
KL-CL-643
KL-CL-644
KL-CL-645
KL-CL-646
KL-CL-647
KL-CL-648
KL-CL-649
KL-CL-650
KL-CL-651
KL-CL-652
KL-CL-653
KL-CL-654
KL-CL-655
KL-CL-656
KL-CL-657
KL-CL-658
KL-CL-659
KL-CL-660
KL-CL-661
KL-CL-662
KL-CL-663
KL-CL-664
KL-CL-665
KL-CL-666
KL-CL-667
KL-CL-668
KL-CL-669
KL-CL-670
KL-CL-671
KL-CL-672
KL-CL-673
KL-CL-674
KL-CL-675
KL-CL-676
KL-CL-677
KL-CL-678
KL-CL-679
KL-CL-680
KL-CL-681
KL-CL-682
KL-CL-683
KL-CL-684
KL-CL-685
KL-CL-686
KL-CL-687
KL-CL-688
KL-CL-689
KL-CL-690
KL-CL-691
KL-CL-692
KL-CL-693
KL-CL-694
KL-CL-695
KL-CL-696
KL-CL-697
KL-CL-698
KL-CL-699
KL-CL-700
KL-CL-701
KL-CL-702
KL-CL-703
KL-CL-704
KL-CL-705
KL-CL-706
KL-CL-707
KL-CL-708
KL-CL-709
KL-CL-710
KL-CL-711
KL-CL-712
KL-CL-713
KL-CL-714
KL-CL-715
KL-CL-716
KL-CL-717
KL-CL-718
KL-CL-719
KL-CL-720
KL-CL-721
KL-CL-722
KL-CL-723
KL-CL-724
KL-CL-725
KL-CL-726
KL-CL-727
KL-CL-728
KL-CL-729
KL-CL-730
KL-CL-731
KL-CL-732
KL-CL-733
KL-CL-734
KL-CL-735
KL-CL-736
KL-CL-737
KL-CL-738
KL-CL-739
KL-CL-740
KL-CL-741
KL-CL-742
KL-CL-743
KL-CL-744
KL-CL-745
KL-CL-746
KL-CL-747
KL-CL-748
KL-CL-749
KL-CL-750
KL-CL-751
KL-CL-752
KL-CL-753
KL-CL-754
KL-CL-755
KL-CL-756
KL-CL-757
KL-CL-758
KL-CL-759
KL-CL-760
KL-CL-761
KL-CL-762
KL-CL-763
KL-CL-764
KL-CL-765
KL-CL-766
KL-CL-767
KL-CL-768
KL-CL-769
KL-CL-770
KL-CL-771
KL-CL-772
KL-CL-773
KL-CL-774
KL-CL-775
KL-CL-776
KL-CL-777
KL-CL-778
KL-CL-779
KL-CL-780
KL-CL-781
KL-CL-782
KL-CL-783
KL-CL-784
KL-CL-785
KL-CL-786
KL-CL-787
KL-CL-788
KL-CL-789
KL-CL-790
KL-CL-791
KL-CL-792
KL-CL-793
KL-CL-794
KL-CL-795
KL-CL-796
KL-CL-797
KL-CL-798
KL-CL-799
KL-CL-800
KL-CL-801
KL-CL-802
KL-CL-803
KL-CL-804
KL-CL-805
KL-CL-806
KL-CL-807
KL-CL-808
KL-CL-809
KL-CL-810
KL-CL-811
KL-CL-812
KL-CL-813
KL-CL-814
KL-CL-815
KL-CL-816
KL-CL-817
KL-CL-818
KL-CL-819
KL-CL-820
KL-CL-821
KL-CL-822
KL-CL-823
KL-CL-824
KL-CL-825
KL-CL-826
KL-CL-827
KL-CL-828
KL-CL-829
KL-CL-830
KL-CL-831
KL-CL-832
KL-CL-833
KL-CL-834
KL-CL-835
KL-CL-836
KL-CL-837
KL-CL-838
KL-CL-839
KL-CL-840
KL-CL-841
KL-CL-842
KL-CL-843
KL-CL-844
KL-CL-845
KL-CL-846
KL-CL-847
KL-CL-848
KL-CL-849
KL-CL-850
KL-CL-851
KL-CL-852
KL-CL-853
KL-CL-854
KL-CL-855
KL-CL-856
KL-CL-857
KL-CL-858
KL-CL-859
KL-CL-860
KL-CL-861
KL-CL-862
KL-CL-863
KL-CL-864
KL-CL-865
KL-CL-866
KL-CL-867
KL-CL-868
KL-CL-869
KL-CL-870
KL-CL-871
KL-CL-872
KL-CL-873
KL-CL-874
KL-CL-875
KL-CL-876
KL-CL-877
KL-CL-878
KL-CL-879
KL-CL-880
KL-CL-881
KL-CL-882
KL-CL-883
KL-CL-884
KL-CL-885
KL-CL-886
KL-CL-887
KL-CL-888
KL-CL-889
KL-CL-890
KL-CL-891
KL-CL-892
KL-CL-893
KL-CL-894
KL-CL-895
KL-CL-896
KL-CL-897
KL-CL-898
KL-CL-899
KL-CL-900
KL-CL-901
KL-CL-902
KL-CL-903
KL-CL-904
KL-CL-905
KL-CL-906
KL-CL-907
KL-CL-908
KL-CL-909
KL-CL-910
KL-CL-911
KL-CL-912
KL-CL-913
KL-CL-914
KL-CL-915
KL-CL-916
KL-CL-917
KL-CL-918
KL-CL-919
KL-CL-920
KL-CL-921
KL-CL-922
KL-CL-923
KL-CL-924
KL-CL-925
KL-CL-926
KL-CL-927
KL-CL-928
KL-CL-929
KL-CL-930
KL-CL-931
KL-CL-932
KL-CL-933
KL-CL-934
KL-CL-935
KL-CL-936
KL-CL-937
KL-CL-938
KL-CL-939
KL-CL-940
KL-CL-941
KL-CL-942
KL-CL-943
KL-CL-944
KL-CL-945
KL-CL-946
KL-CL-947
KL-CL-948
KL-CL-949
KL-CL-950
KL-CL-951
KL-CL-952
KL-CL-953
KL-CL-954
KL-CL-955
KL-CL-956
KL-CL-957
KL-CL-958
KL-CL-959
KL-CL-960
KL-CL-961
KL-CL-962
KL-CL-963
KL-CL-964
KL-CL-965
KL-CL-966
KL-CL-967
KL-CL-968
KL-CL-969
KL-CL-970
KL-CL-971
KL-CL-972
KL-CL-973
KL-CL-974
KL-CL-975
KL-CL-976
KL-CL-977
KL-CL-978
KL-CL-979
KL-CL-980
KL-CL-981
KL-CL-982
KL-CL-983
KL-CL-984
KL-CL-985
KL-CL-986
KL-CL-987
KL-CL-988
KL-CL-989
KL-CL-990
KL-CL-991
KL-CL-992
KL-CL-993
KL-CL-994
KL-CL-995
KL-CL-996
KL-CL-997
KL-CL-998
KL-CL-999
KL-CL-1000
KL-CL-1001
KL-CL-1002
KL-CL-1003
KL-CL-1004
KL-CL-1005
KL-CL-1006
KL-CL-1007
KL-CL-1008
KL-CL-1009
KL-CL-1010
KL-CL-1011
KL-CL-1012
KL-CL-1013
KL-CL-1014
KL-CL-1015
KL-CL-1016
KL-CL-1017
KL-CL-1018
KL-CL-1019
KL-CL-1020
KL-CL-1021
KL-CL-1022
KL-CL-1023
KL-CL-1024
KL-CL-1025
KL-CL-1026
KL-CL-1027
KL-CL-1028
KL-CL-1029
KL-CL-1030
KL-CL-1031
KL-CL-1032
KL-CL-1033
KL-CL-1034
KL-CL-1035
KL-CL-1036
KL-CL-1037
KL-CL-1038
KL-CL-1039
KL-CL-1040
KL-CL-1041
KL-CL-1042
KL-CL-1043
KL-CL-1044
KL-CL-1045
KL-CL-1046
KL-CL-1047
KL-CL-1048
KL-CL-1049
KL-CL-1050
KL-CL-1051
KL-CL-1052
KL-CL-1053
KL-CL-1054
KL-CL-1055
KL-CL-1056
KL-CL-1057
KL-CL-1058
KL-CL-1059
KL-CL-1060
KL-CL-1061
KL-CL-1062
KL-CL-1063
KL-CL-1064
KL-CL-1065
KL-CL-1066
KL-CL-1067
KL-CL-1068
KL-CL-1069
KL-CL-1070
KL-CL-1071
KL-CL-1072
KL-CL-1073
KL-CL-1074
KL-CL-1075
KL-CL-1076
KL-CL-1077
KL-CL-1078
KL-CL-1079
KL-CL-1080
KL-CL-1081
KL-CL-1082
KL-CL-1083
KL-CL-1084
KL-CL-1085
KL-CL-1086
KL-CL-1087
KL-CL-1088
KL-CL-1089
KL-CL-1090
KL-CL-1091
KL-CL-1092
KL-CL-1093
KL-CL-1094
KL-CL-1095
KL-CL-1096
KL-CL-1097
KL-CL-1098
KL-CL-1099
KL-CL-1100
KL-CL-1101
KL-CL-1102
KL-CL-1103
KL-CL-1104
KL-CL-1105
KL-CL-1106
KL-CL-1107
KL-CL-1108
KL-CL-1109
KL-CL-1110
KL-CL-1111
KL-CL-1112
KL-CL-1113
KL-CL-1114
KL-CL-1115
KL-CL-1116
KL-CL-1117
KL-CL-1118
KL-CL-1119
KL-CL-1120
KL-CL-1121
KL-CL-1122
KL-CL-1123
KL-CL-1124
KL-CL-1125
KL-CL-1126
KL-CL-1127
KL-CL-1128
KL-CL-1129
KL-CL-1130
KL-CL-1131
KL-CL-1132
KL-CL-1133
KL-CL-1134
KL-CL-1135
KL-CL-1136
KL-CL-1137
KL-CL-1138
KL-CL-1139
KL-CL-1140
KL-CL-1141
KL-CL-1142
KL-CL-1143
KL-CL-1144
KL-CL-1145
KL-CL-1146
KL-CL-1147
KL-CL-1148
KL-CL-1149
KL-CL-1150
KL-CL-1151
KL-CL-1152
KL-CL-1153
KL-CL-1154
KL-CL-1155
KL-CL-1156
KL-CL-1157
KL-CL-1158
KL-CL-1159
KL-CL-1160
KL-CL-1161
KL-CL-1162
KL-CL-1163
KL-CL-1164
KL-CL-1165
KL-CL-1166
KL-CL-1167
KL-CL-1168
KL-CL-1169
KL-CL-1170
KL-CL-1171
KL-CL-1172
KL-CL-1173
KL-CL-1174
KL-CL-1175
KL-CL-1176
KL-CL-1177
KL-CL-1178
KL-CL-1179
KL-CL-1180
KL-CL-1181
KL-CL-1182
KL-CL-1183
KL-CL-1184
KL-CL-1185
KL-CL-1186
KL-CL-1187
KL-CL-1188
KL-CL-1189
KL-CL-1190
KL-CL-1191
KL-CL-1192
KL-CL-1193
KL-CL-1194
KL-CL-1195
KL-CL-1196
KL-CL-1197
KL-CL-1198
KL-CL-1199
KL-CL-1200
KL-CL-1201
KL-CL-1202
KL-CL-1203
KL-CL-1204
KL-CL-1205
KL-CL-1206
KL-CL-1207
KL-CL-1208
KL-CL-1209
KL-CL-1210
KL-CL-1211
KL-CL-1212
KL-CL-1213
KL-CL-1214
KL-CL-1215
KL-CL-1216
KL-CL-1217
KL-CL-1218
KL-CL-1219
KL-CL-1220
KL-CL-1221
KL-CL-1222
KL-CL-1223
KL-CL-1224
KL-CL-

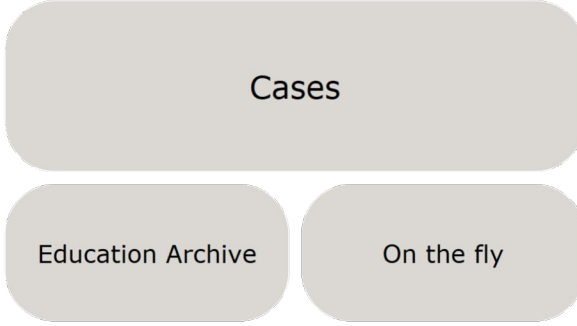

C-panel modülü, her sahne için hayati parametreleri, test sonuçlarını, görüntüleri ve kontrol listelerini hazırlamanıza ve eğitmen için notlar hazırlamanıza (OSCE için kapı notları gibi) olanak tanır.



Düzenle

Vaka Adı : NRP-2

Hasta Yaşı : Belirtilmedi

Departman : Yenidoğan

Son düzenleme : 2022-01-04 12:26:59

GENEL BİLGİ

GÖRÜNTÜLEME

LAB

KONTROL LİSTELERİ

SENARYO

GENEL BİLGİLER

Eğitimin Amacı

Oğrenim Hedefleri

Beceriler / Temel Hekimlik Uygulamaları

Tanı / Bulguları / Semptom / Şikayet

Hikaye - Öğrenciye Verilecek Öneri

Oğrendirlerden ekip olarak, normal spontane vajinal yola doğacak bir bebekte doğum öncesi organizasyon ve hazırlıklardan yapması, doğum sonrası NRP basamaklarını doğru uygulaması ve bebekte görülebilecek bir sorunu ekip olarak uygun şekilde gözlemlemeyi beklenmektedir. Bu işlemler sırasında iletişim becerilerini, kız kaynak yönetimini ve liderlik becerilerini göstermeleri beklenmektedir.

Yenidoğan canlandırması

Balon maske (ambu) kullanımı

Yenidoğanda solunum güçlüğü

Özel hastanede çalışıyorsunuz, VIP bir hasta doğum salonunda video çekimi yapmak istediklerini belirtiyor. Hastane idari sorumlunuz telefonla arayarak sizden mümkün olduğunca isteklere imni baktırmaz istiyor, kabul ediyorsunuz. 5 dakika sonra telefonla bu hastanın kadın doğumcusu sizi telefonla arıyor. Normal doğum planladığını ve sizin de orada olmanızı istiyor.

Sizden telefonda kadın doğum doktorundan hastayla ilgili bilgileri alıp doğum öncesi planlamasını, doğumda resusitasyonu NRP 2020 kılavuzuna uygun yapmanızı, hastada herhangi bir problem gözlemlerseniz klinik aklı yürütme yaparak çözmenizi ve gerekli ise resusitasyon sonrası hasta stabilizasyonunu yapmanızı bekliyoruz.

Çalıştığınız hastanede doğumhanede bir açık yatak var, transport kövüz ve transport mekanik ventilatörünüz var. Doğumhanede hasta takip alanı yok. Yenidoğan yoğun bakım doğumhaneye aynı katta ve yaklaşık 60 santide ulaşabiliyor. Yenidoğan yoğun bakım seviye 3 hizmet veriyor. (Bunları aslında oryantasyonda da vermiş)

Oğrendirlerden ekip olarak, normal spontane vajinal yola doğacak bir bebekte doğum öncesi organizasyon ve hazırlıklardan yapması, doğum sonrası NRP basamaklarını doğru uygulaması ve bebekte görülebilecek bir sorunu ekip olarak uygun şekilde gözlemlemeyi beklenmektedir. Bu işlemler sırasında iletişim becerilerini, kız kaynak yönetimini ve liderlik becerilerini göstermeleri beklenmektedir.

Bu senaryoda öğrenciler ekstra anormal bir şey yapmadıkça vakanın tamamen normal gimesini istemekteyiz, asıl amacımız iletişim becerileri, geç kord klemesi ve NRP başlangıç basamaklarını stres altında bile otomatik düşünmeden yapabilmeleri.

Senaryoyu Başlat

SimClever™ 2020'de kurulduğundan beri kendini sağlık eğitimi yoluyla hasta bakımı ve güvenliğini geliştirmeye adanmıştır. SimClever™ ürünlerini kendi tasarlar, geliştirir ve üretir. SimClever™ ürünleri Türkiye'de doğrudan satış yoluyla satılmaktadır. Ürünleri Türkiye'de satma hakkına aynı zamanda Havelsan da sahiptir, dünyada ise WorldPoint aracılığıyla satılmaktadır.

Garanti

SimClever™ tarafından üretilen ürünler için iki yıllık sınırlı garanti sunulmaktadır. Uzatılmış garanti planları da mevcuttur. Koşullar ve şartlar geçerlidir. Detaylar için lütfen simclever.com adresini ziyaret edin.

Destek

Ürün kullanım kılavuzlarını ve talimat videolarını simclever.com adresinden indirebilirsiniz.

E-posta: info@simclever.com

Telefon: +90 552 879 7562

Çalışma Saatleri: Hafta içi 8:00 - 16:30

Tüm SimClever™ simülatörleri Türkiye'de tasarlanmış, üretilmiş ve monte edilmiştir. Ürün tasarımı ve fiyatı önceden bildirilmeksizin değişebilir.

SimClever™, Rise Together™ ve Meducasim™ Rise Teknoloji Şirketi'nin Ticari Markalarıdır.